

QTEST®

DIGITÁLNÍ ALKOHOLTESTER

S ELEKTROCHEMICKÝM SENZOREM

CA 10FS



Návod k použití

Technické údaje

Senzor:	elektrochemické čidlo
Přesnost:	$\pm 0,05$ ‰ při $0,50$ ‰ alkoholu v krvi (BAC)
Měřicí rozsah:	$0,00 \div 4,00$ ‰ alkoholu v krvi (BAC) $0,00 \div 2,00$ mg/l alkoholu v dechu (BrAC)
Doba zahřívání:	15 - 35 sekund
Doba odezvy:	3 - 22 sekund
Rozměry:	114 x 47 x 24 mm
Hmotnost:	61,5g (84g včetně baterie)
Baterie:	2 ks alkalické baterie 1,5V, typ AAA
Pracovní teplota:	5 - 40 °C
Skladovací teplota:	0 - 40 °C
Kalibrace:	každých 6 měsíců nebo po 500 testech

Záruka

Při dodržení provozních podmínek uvedených v tomto návodu k obsluze a stanovených kalibračních intervalech se poskytuje na případné vady materiálu nebo zpracování při výrobě (s výjimkou kalibrace) záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje.

Záruka výrobce je omezena na opravu, nastavení nebo výměnu přístroje dle vlastního uvážení výrobce nebo pověřeného servisu dodavatele.

Podmínkou uplatnění záruky je předložení řádného prodejního dokladu.

Ze záruky jsou vyjmuty závady způsobené přírodními událostmi a vlivy, nedbalostí zákazníka, nesprávným použitím a zásahy a opravami neautorizovanými osobami. V těchto případech bude zákazníkovi účtována přiměřená úhrada za opravu a náhradní díly.

Upozornění a doporučení

1. Po napití, kouření nebo jídle počkejte alespoň 20 minut.

Je to proto, že přístroj je určen k měření alkoholu v krvi (nikoli alkoholových par v ústech krátce po napití, což by nemělo žádnou vypovídací hodnotu) a trvá přibližně 20 minut, než je alkohol absorbován ze zažívacích orgánů do krve. Rovněž zbytkový alkohol v ústech potřebuje tuto dobu pro vyprcháání, aby neovlivňoval měření.

Pozor! Fouknutí do přístroje bezprostředně po požití alkoholu může vést vzhledem k vysoké koncentraci alkoholu k trvalému poškození velmi citlivého senzoru a tím i ztrátě záruky!

2. Neprovádějte měření za silného větru nebo v uzavřené místnosti s kontaminovaným vzduchem.
3. Když se na displeji objeví nápis <BAT>, vyměňte 1,5V alkalické baterie (nedobíjecí!).
4. Nevydechujte do přístroje cigaretový kouř, rovněž do přístroje nesmí vniknout jakákoli kapalina. Došlo by k vážnému poškození nebo zničení senzoru.
5. Nepoužívejte tento přístroj jako pomůcku k určení, zda Vy nebo kdokoliv jiný může řídit motorové vozidlo nebo stroj.
6. Přístroj uchovávejte při teplotě v rozmezí 0 - 40 °C, používejte při teplotách v rozmezí 5 - 40 °C. Používání přístroje při vyšších nebo nižších teplotách ovlivní přesnost měření.
7. Souvztažnost mezi obsahem alkoholu v dechu a koncentrací alkoholu v krvi závisí na mnoha proměnných, včetně faktorů životního prostředí (např. kvalita ovzduší, vítr, vlhkost, teplota, atd.) a zdravotního stavu testované osoby.
8. Při normálním používání je vhodné nechat přístroj kalibrovat každých 6 měsíců nebo po 500 měřeních pro získání přesných výsledků. Adresu kalibrační laboratoře najdete na zadní straně tohoto návodu.
9. Výsledky měření tímto přístrojem nemůžete použít před soudem. Řidič sám nese plnou zodpovědnost za řízení pod vlivem alkoholu.
10. Nepoužívejte tento přístroj společně se zařízením, zabraňujícím nastartování, nebo když sedíte v motorovém vozidle.
11. Výsledky testování jedné osoby se mohou průběžně zvyšovat nebo snižovat, což závisí na mnoha faktorech. Výsledek testování v jednom okamžiku neznamená, že tento výsledek bude stejný i po několika minutách.
12. Nenechte sebe ani kohokoliv jiného řídit po požití alkoholického nápoje. Vždy ponechte řídit pouze osobu, která nepožila ani nejmenší množství alkoholického nápoje.

Tento přístroj je tester alkoholu v dechu, určený pro měření přítomnosti alkoholu v krvi. Prosíme, před jeho používáním si pečlivě přečtete tento Návod k použití.

Popis přístroje



LED displej

- Výsledek testu je na displeji zobrazen ve formátu 0,00 (BrAC / ‰ BAC).
- Jednotka měření je nastavena dle místního standardu.



Zelená LED
se rozsvítí, jakmile je přístroj připraven k měření. Také bude svítit, pokud výsledek měření bude nižší než varovná hodnota.



READY



BATT LOW



WARN

Červená LED
se rozsvítí, jestliže výsledek testu přesahuje hodnotu 0,50 ‰ / 025 mg/l.

Žlutá LED bude blikat, pokud je nízké napětí baterie. Vyměňte alkalické baterie 1,5V.


Návod k použití

- 1. Do otvoru na straně přístroje nasadíte hygienický náústek.**
 - 2. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP na pravé straně pod LED displejem.**
 - Nejříve se zobrazí „plný displej“ a nápis <On> současně se zvukovým signálem. Poté začne odpočet, který bude trvat 15 až 35 sekund. Tento zahřívací proces připravuje elektroniku a senzor na testování.
 - 3. Jakmile uslyšíte zvukový signál a na displeji se zobrazí nápis <bLo>, začněte foukat do náústku. Nejprve uslyšíte „klapnutí“ a poté dvojité pípnutí. V tuto chvíli přestaňte foukat.**
 - Pokud nezačnete foukat do 20 sekund, přístroj se automaticky vypne. V tom případě jej zapněte znovu.
 - 4. Po ukončení foukání se na displeji po dobu 3-22 sekund zobrazují cirkulující čárky, poté je výsledek testu zobrazen po dobu 20 sekund současně se zvukovým signálem.**
 - V případě, že výsledek testu je vyšší než hodnota 0,50 % / 0,25mg/l (výchozí nastavení), varovný signál <WARN> (červená LED) se rozsvítí a současně zazní zvukový signál. Výsledek bude zobrazen po dobu 20 sekund. (Prvních 15 sekund bude zobrazen výsledek testu na displeji současně s LED kontrolkami <READY> nebo <WARN>, dalších 5 sekund budou LED kontrolky vypnuty). Pokud stisknete tlačítko **ZAP/VYP** během posledních 5 sekund, kdy jsou LED kontrolky <READY> nebo <WARN> vypnuty, přístroj se přepne zpět na odpočet pro další testování.
 - 5. Nakonec se přístroj sám automaticky vypne, na displeji se zobrazí nápis <OFF> doprovázený zvukovým signálem.**
 - 6. Pro následující testování postupujte dle bodů 2 až 4.**
 - 7. Mezi jednotlivými testy ponechávejte přestávku alespoň 2 minuty.**
- Po použití můžete přístroj vypnout stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 2 sekund.

Výměna baterie

Lehce zatlačte na kryt bateriového prostoru (na značku) na zadní straně přístroje, posuňte jej dolů a uvolněte jej z přístroje.

Viz toto zobrazení:

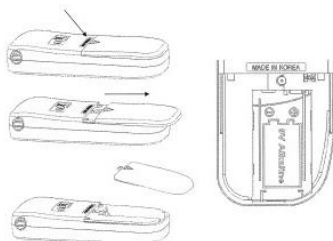

Poznámka:

Dbejte na to, aby baterie byla vložena se správnou polaritou (“+” a “-“), jak je znázorněno na obrázku. Při opačném vložení dojde k nevratnému poškození přístroje!

Chybová hlášení

Chybová zpráva	Příčina a činnost	Chybová zpráva	Příčina a činnost
 READY BATT LOW WARN	Jestliže naměřená hodnota bude vyšší, než 0,50 ‰ BAC / 0,25 mg/l BrAC, rozsvítí se červená LED WARN, doprovázená výstražným zvukovým signálem.	 READY BATT LOW WARN	Napětí baterie je pro provedení testu příliš nízké. Přístroj se po zobrazení této zprávy automaticky vypne. Vyměňte 1,5V alkalické baterie.
 READY BATT LOW WARN	Jestliže naměřená hodnota bude vyšší, než 4,00 ‰ BAC / 2,00 mg/l BrAC, na displeji se objeví nápis Hot, doprovázený výstražným zvukovým signálem.	 READY BATT LOW WARN	Příliš krátký výdech během testu. Uživatel pravděpodobně nevydechoval stejnoměrně a soustavně po dobu cca 3 - 5 sekund. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro další test.
 READY BATT LOW WARN	Jestliže počet měření bude vyšší než 500, na displeji se objeví nápis CAL. I když přístroj stále funguje, je potřeba kalibrace. obraťte se, prosím, na naši kalibrační laboratoř nebo na svého prodejce.	 READY BATT LOW WARN	Pokud je okolní teplota mimo rozsah pracovní teploty (5 - 40° C), na displeji se zobrazí nápis OUT a poté se přístroj vypne. Uchovávejte a používejte přístroj pouze v doporučeném teplotním rozsahu.